

QuickGel 6200 凝胶成像系统操作速览

一. 开机 (后方开关: O 表示关机, I 表示开机)

二. 软件自启动

开机后自动进入拍摄界面, 若需要进行核酸胶拍摄, 则把内置白板抬起, 若需要进行蛋白胶拍摄, 则把内置白板放下。




白板抬起,
拍核酸胶

白板放下,
拍蛋白胶

三. 选择光源

选择落射白光、透射白光或者透射紫外打开, 根据凝胶大小按需选择不同变焦。

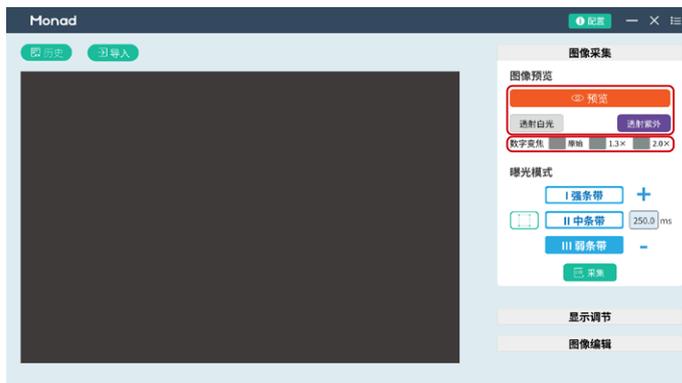


四. 曝光采集

可选定 ROI 进行自动曝光或手动输入曝光时间, 然后采集。




五. 显示范围调节 (此步骤可选)

根据图像效果调节灰度显示范围。

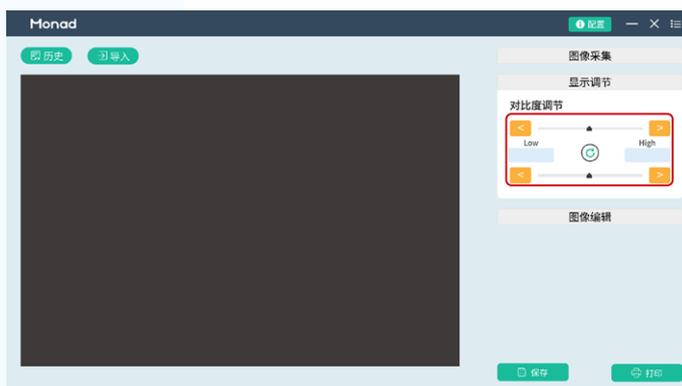

六. 图像编辑 (此步骤可选)

根据需求进行旋转、裁剪、反色、伪彩、注释等操作。

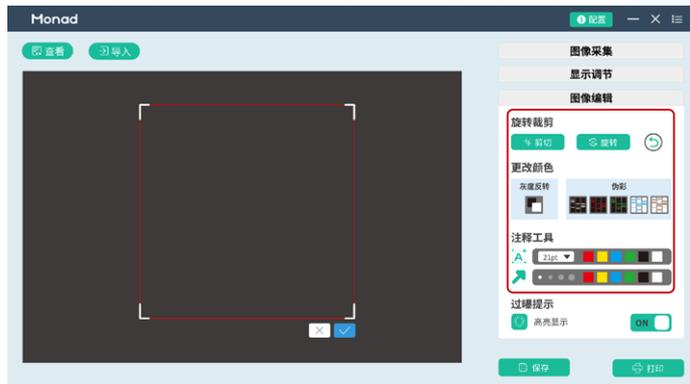

七. 保存

点击保存, 选择保存格式, 编辑样品名称, 选择保存路径。



八. 查看历史图片

点击历史, 可查看近期拍摄的图片。



九. 关机

先关闭软件, 然后关闭电脑, 最后关闭仪器后方机械按键。